



CCR

Programme de dépistage  
du cancer du sein


## Test qualité

**Critères et seuils minimums  
pour la réussite du test de qualité**

# A. Pectoral MLO

Pectoral MLO + Pli infra-mammaire MLO

**moyenne  $\geq 75\%$**

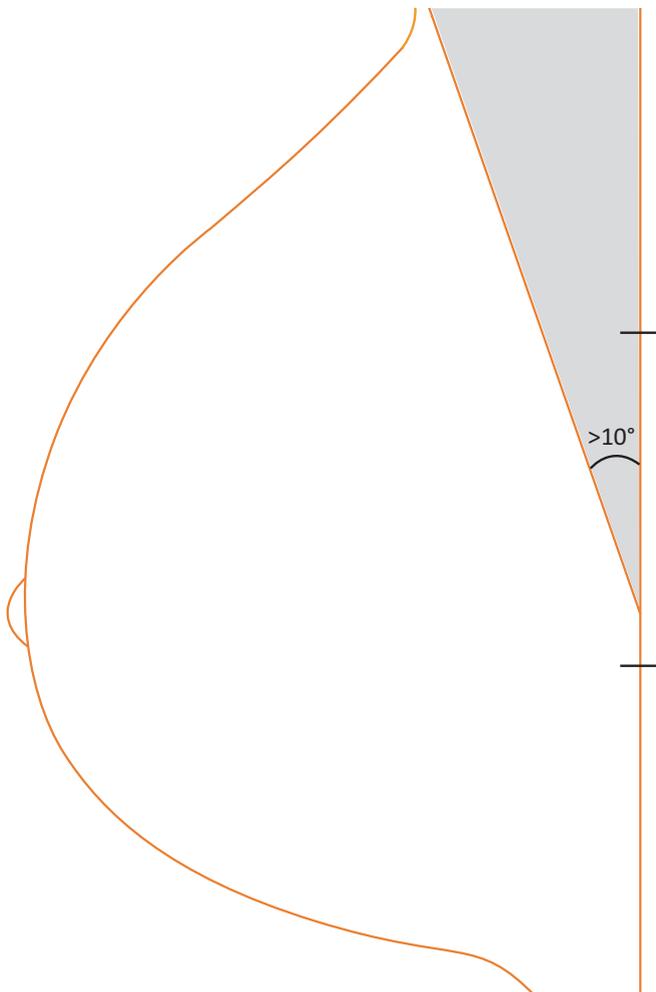

## Critères

---

1. Symétrique D - G\*
2. Angle  $> 10^\circ$
3. Pointe du pectoral entre 1/3 et 2/3

## Cotes

---

1 = 1 + 2 + 3

0,5 = 1 + 2

0 = 1 seul critère, pas ou quasi pas de pectoral

\*si pas symétrique 0,5 pour le pectoral répondant le mieux aux critères et pour autant que les critères 2 et 3 soient respectés et 0 pour l'autre côté


## **B. Pli infra-mammaire MLO**

Pectoral MLO + Pli infra-mammaire MLO


**moyenne  $\geq 75\%$**

### **Critères et côtes**


---

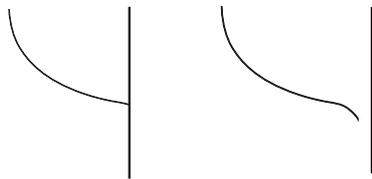

1 = peau orientée vers le bas avec ou sans tissu graisseux sous-cutané




0,5 = angle de  $90^\circ$  entre peau du sillon et plan pectoral



0 = angle  $< 90^\circ$

## **C. Pectoral FACE (20%)**

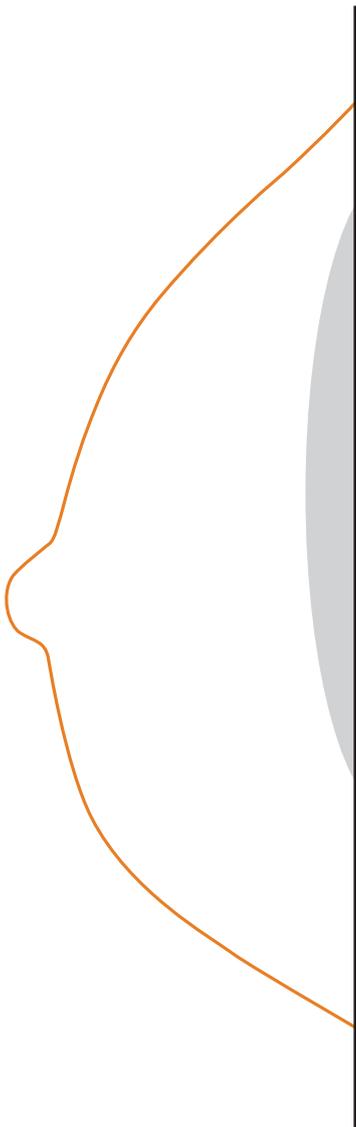

### **Critères**

---

1. Plutôt externe
2. Bord antérieur net
3. Structure fibrillaire
4. Corrélation avec le pectoral MLO

### **Cotes**

---

- 1 = pectoral visible
- 0,5 = doute sur la présence du pectoral
- 0 = pas visible

## **D. Distance mamelon-pectoral (75%)**

### **Critère**

---

Différence entre CC et MLO

### **Cotes**

---

1 = différence < 20%


0,5 = différence entre 20 et 30%

0 = différence > 30%

## **E. Tangence au mamelon (75%)**

### **Critères et cotes**

---

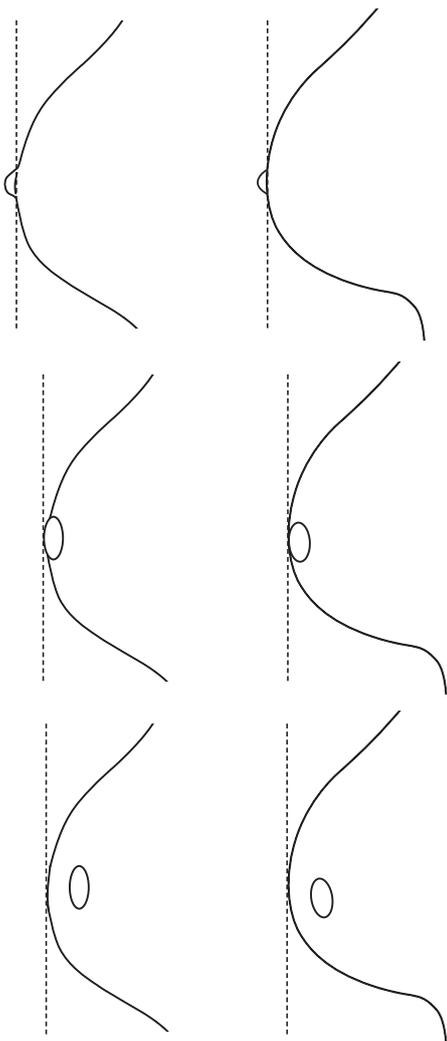

1 = mamelon en dehors de la tangente au bord du sein sur au moins 1 cliché

0,5 = mamelon touche la ligne de la tangente au sein sur au moins 1 cliché

NB : sauf mamelons ombiliqués

0 = mamelon en dedans de la tangente au bord du sein

## **F. Exposition (80%)**

### **Cotes**

---

- 1 = bonne exposition (avec ou sans réglages sur la console)
- 0,5 = 1 cliché dont l'exposition n'est pas satisfaisante
- 0 = mauvaise exposition

## **G. Compression/Positionnement (80%)**

### **Critères**

---

Sein non fixé en MLO et mamelon trop bas  
Plis visibles en MLO au niveau pectoral en haut et du sillon sous mammaire en bas et en CC  
Contour du sein non vu en entièreté (sein coupé)

### **Cotes**

---

- 1 = 0 pli et sein fixé en MLO + mamelon ok + sein vu en entièreté
- 0,5 = 1 pli et/ou contour du sein non vu en entièreté ne gênant pas la lecture
- 0 = 2 plis et/ou sein non fixé en MLO et mamelon trop bas et/ou contour du sein non vu en entièreté gênant la lecture

## **H. Artefacts (80%)**

### **Critères (liste non exhaustive)**

---

- Bijoux, cheveux, nez, doigts si projection sur le sein
- Lignes, lignes festonnées, griffes, bruit de fond, grilles
- Ligne bord film côté pectoral si > 2 mm

**N.B. : artefacts de positionnement (plis) voir item «Compression»**

### **Cotes**

---

- 1 = DR et CR : pas d'artéfact  
CR : ligne bord film côté pectoral <2 mm
- 0,5 = DR et CR = artefacts ne gênant pas la lecture (en dehors du sein)  
ou en superposition du sein mais discret  
DR : ligne bord film côté pectoral <2 mm
- 0 = DR et CR : artefacts gênant la lecture et en superposition du sein  
ou ligne bord film côté pectoral >2 mm